Parameters en gebruiksaanwijzing voor de JT-69 en JT-69B stofafdekkingen


Deze stofkap voor tandtechnici, bedoeld voor polijsten en slijpen, is een ingenieus ontwerp dat ergonomische esthetiek combineert met de praktische behoeften van de tandtechnicus. Er zijn twee types: met intern vacuüm (JT-69) en met extern vacuüm (JT-69B).

Na het uitpakken van de doos monteert u de elleboogbeugels aan de linker- en rechterzijde met de meegeleverde schroeven volgens het schema, haalt u het netsnoer tevoorschijn en sluit u dit aan, zet u de hoofdschakelaar aan, waarna de verlichting en de stofzuiger bediend kunnen worden. Dankzij de vrijwel geruisloze, krachtige stofzuiger en het driewegs schaduwloze verlichtingsontwerp in de behuizing kan de tandtechnicus zich volledig op het werk concentreren. De afvalbak aan de onderzijde kan worden verwijderd voor het verwerken van poeder en vervolgens weer worden teruggeplaatst.

Als de stekker van de 69B (stofafscherming voor tandtechnici (externe stofzuiger vereist)) is ingeschakeld, sluit u gewoon de Φ 50 PVC-buis die is aangesloten op de centrale stofzuiger aan op de achterste buisaansluiting van de kast om aan de slag te gaan.

	○ JT-69-parameters	○ JT-69B-parameters
1. Afmetingen verpakking: 55 x 53 x 35 cm	√ Gewicht: 16 kg (18 kg) √	Gewicht: 10 kg
2. Afmetingen van het product: 50 x 47,5 x 30 cm	√	√
3. Ingangsspanning: 110~240 V, 50~60 Hz	√	√
4. Ingebouwde stofzuiger a, Voedingsspanning: (a) 220 V, 50 Hz (b) 110 V, 60 Hz (optioneel) b, maximale atmosferische druk: 15 kPa c, maximale onderdruk: -8,8 kPa d, maximaal geluidsniveau: -55 dB Motorvermogen: 180 W		
5. Ingebouwde verlichting a, Ingangsspanning: 100~240 V, 50~60 Hz b, vermogen: 14 W c, lichtopbrengst: 1400 lm d, kleurtemperatuur: 6500 K e: geeft P280 aan		

oyodental.nl

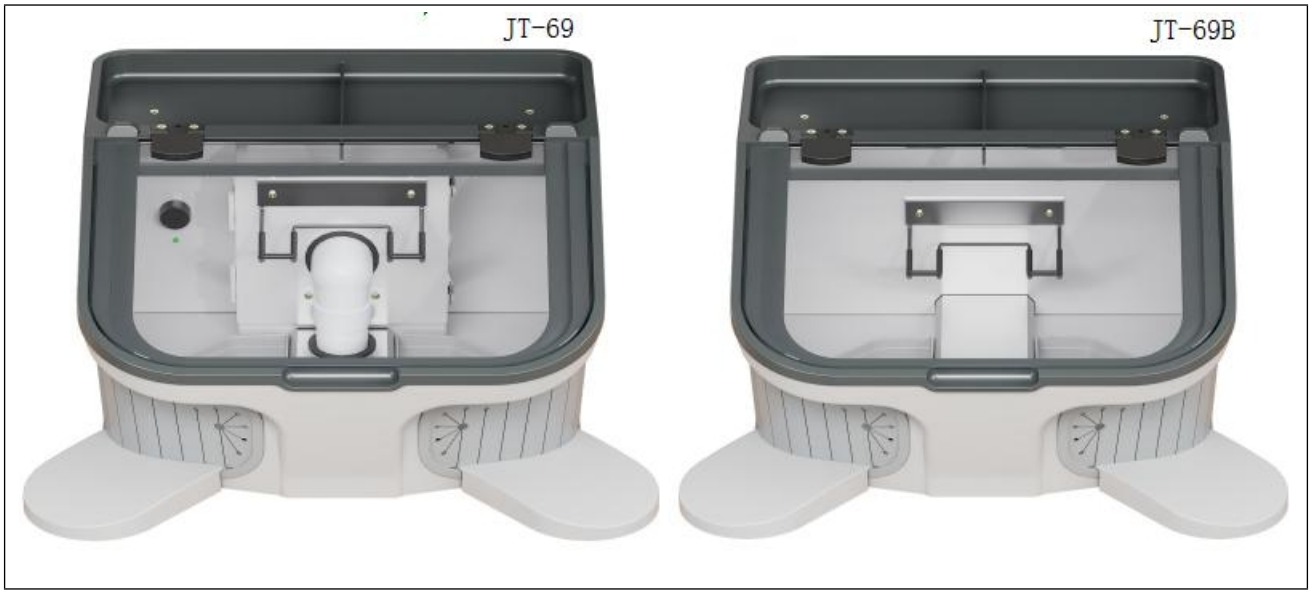

Opmerking: Laat de tandtechnicus de stofkap om de twee diensten controleren, maak de stofopvangzak schoon en vervang deze om de twee weken door een nieuwe zak. Vervang de koolborstel of vervang de motor direct.

oyodental.nl